

00122179.eps

## de Zu Ihrer Sicherheit

### **WANRUNG**

#### UM TOD ODER SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG ZU VERMEIDEN, FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN:

- Dräger-Röhrchen nur verwenden, wenn
- Sie diese Gebrauchsanweisung (Dräger-Röhrchen) sowie die Gebrauchsanweisung der Dräger-Röhrchen Pumpe vollständig verstehen und einhalten können,
- Sie durch Ihren Arbeitgeber in die sachgemäße Verwendung des Dräger-Röhrchens eingewiesen wurden,
- Sie Ihrem Arbeitgeber bereits praktisch vorgeführt haben, dass sie die sachgemäße Verwendung des Dräger-Röhrchens beherrschen!
- Der Inhalt des Dräger-Röhrchens ist toxisch/ätzend. Nicht verschlucken. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Dräger-Röhrchen nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung benutzen (siehe „Verwendungszweck“, unten!).
- Vor jeder Messung eine Dichtheitsprüfung der Dräger-Röhrchen Pumpe mit einem unbenutzten Dräger-Röhrchen durchführen, um etwaige Fehlanzeichen zu vermeiden.
- **Beide** Spitzen des Dräger-Röhrchens abbrechen, bevor das Dräger-Röhrchen in die Dräger-Röhrchen Pumpe eingesetzt wird, da sonst keine Messung möglich ist!
- Beim Einsetzen des Dräger-Röhrchens muss der schwarze Pfeil zur Dräger-Röhrchen Pumpe zeigen, da sonst keine Messung möglich ist.
- Das Röhrchen enthält eine Ampulle, die vor oder nach der Messung gebrochen werden muss, sonst erfolgt kein Farbumschlag in der Anzeigeschicht.
- Nach dem Aufbrechen der inneren Glasampulle durch Biegen des Dräger-Röhrchens die Schutzhüle des Röhrchens (**2**) auf Schäden überprüfen. Bei Beschädigung Dräger-Röhrchen nicht verwenden!
- Um Fehlanzeigen zu vermeiden, nur Dräger-Röhrchen verwenden, die ein gültiges Halbjahresdatum aufweisen (siehe Verpackung) und ausschließlich im vorgegebenen Temperaturbereich gelagert wurden (siehe Verpackung)!
- Ausschließlich mit Dräger-Röhrchen Pumpe verwenden, da die Verwendung von Pumpen anderer Hersteller zu Fehlanzeigen führen kann!

## 1 Verwendungszweck

Bestimmung von Chlorcyan in Luft und technischen Gasen.

## 2 Reaktionsprinzip

CICN + Pyridin → Glutaconaldehydcyanamid  
Glutaconaldehydcyanamid + Barbitalösung → rosa Reaktionsprodukt.

## 3 Messung durchführen und auswerten

1. Sicherstellen, dass die Messumgebung gut ausgeleuchtet ist.
2. Beide Spitzen des Anzeigerohrchens mit dem Dräger-Röhrchenöffner aufbrechen. (Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen.)
3. Durch Biegen des Röhrchens um ca. 45° an der mit 2 schwarzen Punkten gekennzeichneten Bruchstelle (**1**) die Reagenzampulle öffnen, Ampullenflüssigkeit auf die Anzeigeschicht schleudern, bis diese völlig benetzt ist.
4. Dräger-Röhrchen dicht in die Dräger-Röhrchen Pumpe einsetzen. Der Pfeil muss zur Dräger-Röhrchen Pumpe zeigen (**4**), da sonst keine Messung möglich ist.
5. Luft- oder Gasprobe mit so vielen Hübchen durch das Röhrchen saugen, bis der Faktor der Farbvergleichsschicht übereinstimmt. Maximal 20 Hübchen machen.
6. Auswertung gemäß folgender Tabelle bei Farbledigkeit:

Hubzahl	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Konzent. (ppm)	5	2,5	1,6	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25

7. Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren. Ergebnis im Messprotokoll notieren.
8. Mögliche Querempfindlichkeiten beachten.
9. Dräger-Röhrchen Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen, dazu Dräger-Röhrchen entfernen und 3-4 Hübchen Frischluft einsaugen.

1 ppm Chlorcyan = 2,56 mg Chlorcyan/m<sup>3</sup>

1 mg Chlorcyan/m<sup>3</sup> = 0,39 ppm Chlorcyan (bei 20 °C, 1013 hPa)

## 4 Technische Daten

Messbereich: 0,25 bis 5 ppm Hubzahl (n): 1 - 20  
Standardabweichung: ± 30 % Farbumschlag: weiß → rosa

Dauer der Messung: max. 5 Minuten

Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

## 5 Umgebungsbedingungen

Temperatur: 5 °C bis 40 °C

Feuchtigkeit: <50 mg H<sub>2</sub>O/L (entspr. 100 % r.F. bei 40 °C)

## 6 Querempfindlichkeiten

- Bromcyan wird ebenfalls angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

## 7 Entsorgung

Die Verpackung der Dräger-Röhrchen enthält Angaben zu Bestellnummer, Haltbarkeit, Lagertemperatur und Seriennummer. Dräger-Röhrchen gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten aufbewahren.

## 8 Bei Fragen

Bei Fragen oder Problemen hinsichtlich der sachgemäßen Verwendung des Dräger-Röhrchens wenden Sie sich bitte an Ihre Dräger-Niederlassung oder Vertretung. Für Kunden in den USA: Rufen Sie Dräger Safety Inc. gebührenfrei unter 1-888-794-3806 an.

## it Per la vostra sicurezza

### **AVVERTENZA**

#### PER EVITARE IL RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DI SICUREZZA RIPORTATE DI SEGUITO.

- Utilizzare la fiala Dräger solo se
- si è in condizione di comprendere e rispettare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso (fiala Dräger) nonché le istruzioni per l'uso della pompa per fiale Dräger;
- siete stati istruiti al corretto utilizzo della fiala Dräger dal vostro datore di lavoro,
- avete già dimostrato concretamente al vostro datore di lavoro la perfetta conoscenza del corretto utilizzo della fiala Dräger!
- Il contenuto della fiala Dräger è tossico/corrosivo. Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Utilizzare la fiala Dräger solo in modo conforme a quanto previsto (vedere "Utilizzo previsto" qui sotto!)
- prima di ogni misurazione, effettuare una prova di tenuta della pompa per fiale Dräger con una fiala Dräger inutilizzata, per evitare eventuali risultati errati,
- Rompere entrambe le punte della fiala Dräger, prima che questa venga inserita nella pompa per fiale Dräger, poiché altrimenti non si può effettuare alcuna misurazione!
- Nell'inserire la fiala Dräger, la freccia nera deve puntare verso la pompa di rilevamento gas Dräger, poiché altrimenti non si può effettuare alcuna misurazione.
- La fiala contiene un'ampolla che deve essere rotta prima o dopo la misurazione, altrimenti non si verifica alcun viraggio di colore nello strato indicatore.
- Dopo aver aperto l'ampolla di vetro interna, piegando la fiala Dräger, verificare che l'involucro di protezione della fiala (**2**) non sia danneggiato. In caso di danneggiamento non utilizzare la fiala Dräger!
- Per evitare risultati sbagliati, utilizzare solo fiale Dräger con una data di scadenza valida (vedere la confezione) e che siano state conservate esclusivamente nell'intervallo di temperatura stabilito (vedere la confezione)!
- Utilizzare esclusivamente la pompa per fiale Dräger. poiché l'utilizzo di pompe di altri produttori può comportare risultati errati!

## 1 Utilizzo previsto

Determinazione del cloruro di cianogeno nell'aria e nei gas tecnici.

## 2 Princípio di reazione

CICN + piridina → cianammide di aldeide glutaconica

Cianammide di aldeide glutaconica + acido barbiturico → prodotto di reazione rosa.

## 3 Realizzazione e analisi della misurazione

Assicurarsi che l'ambiente di misurazione sia ben illuminato.

2. Rompere entrambe le punte della fiala indicatrice con l'aprifile Dräger (fare attenzione nell'aprire la fiala, potrebbero saltare dei frammenti di vetro).

3. Aprire l'ampolla del reagente piegando la fiala di 45° nel punto di rottura (**1**), contrassegnato con i due punti neri; agitare poi il liquido dell'ampolla direzionandolo sullo strato indicatore, finché quest'ultimo non è completamente bagnato.

4. Fissare bene la fiala Dräger nella pompa per fiale Dräger. La freccia deve puntare verso la pompa per fiale Dräger (**4**), poiché altrimenti non si può effettuare alcuna misurazione.

5. Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala con tante pomate quante ne occorrono per fare in modo che il fattore dello strato di confronto cromatico coincida. Effettuare al massimo 20 pomate.

6. Valutazione a parità di colore secondo la tabella seguente:

Numeri di pomate	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Concentr. (ppm) 5 2,5 1,6 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25



7. Moltiplicare il valore per il fattore F per la correzione della pressione dell'aria. Annotare il risultato nel rapporto di misurazione.

8. Fare attenzione a eventuali effetti di sensibilità trasversale.

9. Dopo l'utilizzo, ripulire la pompa per fiale Dräger con aria, rimuovere la fiala Dräger ed effettuare 3-4 pomate per aspirare aria pulita.

1 ppm di cloruro di cianogeno = 2,56 mg di cloruro di cianogeno/m<sup>3</sup>

1 mg di cloruro di cianogeno/m<sup>3</sup> = 0,39 ppm di cloruro di cianogeno (a 20 °C, 1013 hPa)

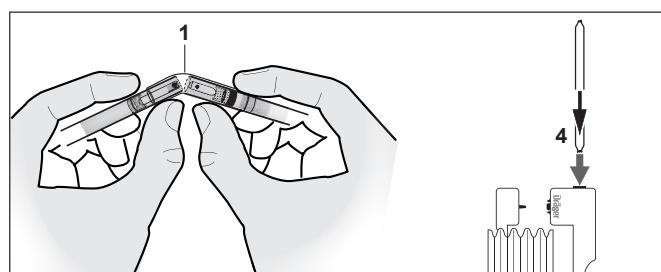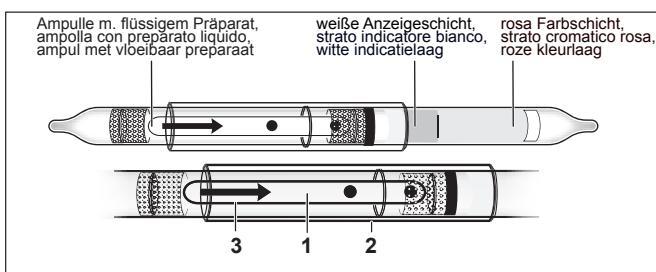

#### 4 Dati tecnici

Campo di misura: da 0,25 a 5 ppm Numero di pompe (n): 1 - 20  
Variazione standard: ± 30 % Viraggio di colore: bianco → rosa  
Durata della misurazione: max. 5 minuti  
Fattore di correzione:  $F = 1013/\text{pressione atmosferica reale (hPa)}$

#### 5 Condizioni ambientali

Temperatura: da 5 °C a 40 °C  
Umidità: <50 mg H<sub>2</sub>O/L (corrisp. a 100 % UR a 40 °C)

#### 6 Effetti di sensibilità trasversale

- Il bromuro di cianogeno viene altrettanto indicato, ma con una sensibilità differente.

#### 7 Smaltimento

Sulla confezione delle fiale Dräger sono riportati codice dell'articolo, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. Smaltire le fiale Dräger in conformità alle disposizioni del luogo relativo allo smaltimento. Mantenere fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

#### 8 In caso di domande

In caso di domande o problemi relativi all'utilizzo conforme della fiala Dräger rivolgersi alla sede o al rappresentante Dräger locale. Per i clienti degli Stati Uniti: contattare Dräger Safety Inc. gratuitamente al numero 1-888-794-3806.

#### nl Voor uw veiligheid



#### WAARSCHUWING

#### OM DODELIJK OF ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT MEN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP TE VOLGEN:

- Gebruik de Dräger-buisjes alleen, wanneer
- deze gebruiksaanwijzing (Dräger-buisjes) en de gebruiksaanwijzing van de Dräger-buisjespomp volledig begrijpt en kunt naleven,
- u door uw werkgever werd geïnstrueerd in het correcte gebruik van de Dräger-buisjes,
- u aan uw werkgever reeds in de praktijk heeft aangetoond dat u het correcte gebruik van de Dräger-buisjes beheert!
- De inhoud van de Dräger-buisjes is toxicus/etsend. Niet doorslikken. Huid- en oogcontact vermijden.
- Gebruik Dräger-buisjes alleen overeenkomstig het beoogde gebruiksdool (zie "Beoogd gebruik" hieronder).
- Controleer vóór elke meting de Dräger-buisjespomp met een ongeopend Dräger-buisje op lekkage om eventuele foutieve aanwijzingen te voorkomen.
- Breek **beide** punten van het Dräger-buisje af, voordat het Dräger-buisje in de Dräger-buisjespomp wordt geplaatst, anders is geen meting mogelijk!
- Tijdens het plaatsen van het Dräger-buisje moet de zwarte pijl naar de Dräger-buisjespomp wijzen, anders is geen meting mogelijk!
- Het buisje bevat een ampul die voor of na de meting opengebroken moet worden, anders vindt geen kleuromslag plaats in de indicatielaag.
- Na het openbreken van de binnenneste glazen ampul door het Dräger-buisje te buigen, dient men de beschermende huls van het buisje (2) op beschadiging te controleren. In geval van beschadiging het Dräger-buisje niet gebruiken!
- Gebruik ter voorkoming van foutieve aanwijzingen alleen Dräger-buisjes die een geldige houdbaarheidsdatum hebben (zie verpakking) en uitsluitend binnen het voorgeschreven temperatuurbereik opgeslagen werden (zie verpakking).
- Gebruik de buisjes uitsluitend met de Dräger-buisjespomp, het gebruik van pompen van andere producenten kan tot foutieve aanwijzingen leiden!

#### 1 Beoogd gebruik

Bepaling van chloorkyaan in de lucht en technische gassen.

#### 2 Reactieprincipe

CICN + pyridine → glutaconaldehydecyanamide

Glutaconaldehydecyanamide + barbituurzuur → roze reactieproduct.

#### 3 Meting uitvoeren en beoordelen

- Zorg ervoor dat de meetomgeving goed verlicht is.
- Breek beide punten van het indicatiabuisje open met de Dräger-buisjesopener. (Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters wegspatten.)
- Door het buisje ca. 45° op het met 2 zwarte punten gemarkeerde breekpunt (1) te buigen, de reagensampul openen en de, ampulvloeistof over de indicatielaag verspreiden tot deze volledig is bevochtigd.
- Plaats het Dräger-buisje stevig in de Dräger-buisjespomp. De pijl moet naar de Dräger-buisjespomp wijzen (4), anders is geen meting mogelijk!
- Lucht- of gasmonster met zoveel pompslagen door het buisje zuigen, tot de factor van de kleurvergelijkingsslag overeenstemt. Maximaal 20 pompslagen uitvoeren.
- Beoordeling volgens de volgende tabel bij kleurgelijkheid:

Aantal pompslagen	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Concentr. (ppm) 5 2,5 1,6 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25

- Vermenigvuldig de waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie. Noteer het resultaat in het meetprotocol.
- Houd rekening met eventuele kruisgevoeligheden.